

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2025**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 104/2025**

A Prefeitura de Unai torna público para conhecimento dos interessados a **RETIFICAÇÃO** ao edital do Pregão Eletrônico ao instrumento convocatório:

**Onde se lê:**

01	<p>Analizador de eletrólitos (1300 testes na+,k+ e cl -/mês), com configuração de bancada, capacidade de autodiagnóstico, eletrodos íons seletivos ou biosensores, alto desempenho , programas de calibração automática de 1-2 pontos, sistema de amostragem com função de limpeza de circuito automática após cada análise, capacidade de análise de 60 amostras por hora, volume de aspiração de até 150 microlitros, resultados precisos em até 60 segundos, possuir leitor de código de barras para amostras e reagentes(pack), tela lcd com touch screen, possibilidade de desligamento do mesmo sem perda de estabilidade do pack, ou manutenções dos eletrodos ao ligar o mesmo, controle de qualidade on-line com gráfico de levy jennings e regras de westgard, alimentação elétrica 110w ou bivolt automático, acompanhado de nobreak(novo, primeiro uso) com automia de no mínimo 15 min., apresentação de parâmetros reportáveis k<sup>+</sup>, na<sup>+</sup>, cl<sup>-</sup> com software em português. Assistências técnicas (manutenção preventiva e corretiva) durante a execução do contrato.</p>	M	7	R\$ 11.446,66
----	---	---	---	---------------

**Leia-se:**

01	<p>Analizador de eletrólitos (1300 testes), sendo o valor de 1.300 testes para cada analito( 1.300 testes de Na<sup>+</sup>, 1.300 testes de K<sup>+</sup> e 1.300 teste de Cl<sup>-</sup>) com configuração de bancada, capacidade de autodiagnóstico, eletrodos íons seletivos ou biosensores, alto desempenho , programas de calibração automática de 1-2 pontos, sistema de amostragem com função de limpeza de circuito automática após cada análise, capacidade de análise de 60 amostras por hora, volume de aspiração de até 150 microlitros, resultados precisos em até 60 segundos, possuir leitor de código de barras para amostras e reagentes(pack), tela lcd com touch screen, possibilidade de desligamento do mesmo sem perda de estabilidade do pack, ou manutenções dos eletrodos ao ligar o mesmo, controle de qualidade on-line com gráfico de levy jennings e regras de westgard, alimentação elétrica 110w ou bivolt automático, acompanhado de nobreak(novo, primeiro uso) com automia de no mínimo 15 min., apresentação de parâmetros reportáveis k<sup>+</sup>, na<sup>+</sup>, cl<sup>-</sup> com software em português. Assistências técnicas (manutenção preventiva e corretiva) durante a execução do contrato.</p>	M	7	R\$ 11.446,66
----	---	---	---	---------------

**Onde lê-se:**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

3.1. O prazo de vigência do contrato é de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

**Leia-se:**


**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

3.1. O prazo de vigência do contrato é de 07(sete) meses contados a partir \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ à \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, na forma do artigo 105 da Lei 14.133/21, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

Dessa forma a data de fim do recebimento da proposta e início da disputa altera-se para o dia 09 de julho de 2025, sendo o fim de recebimento da proposta às 09:00 horas e início da disputa às 09:10 horas do mesmo dia.

Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados. Esta Errata integra o edital respectivo, para todos os efeitos legais.

Unai, 23 de junho de 2025

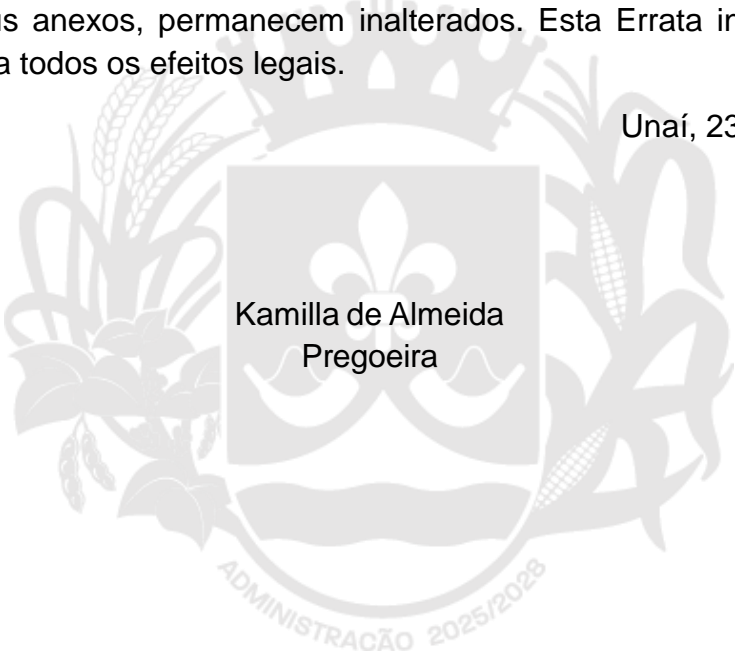

Kamilla de Almeida  
Pregoeira